


DI SEGUITO 3 PROVE, ESEGUITE CON GDV CAMERA, EFFETTUATE PER TESTARE L'EFFICACIA DEL BIOLASER® UTILIZZABILE IN TUTTI I TIPI DI RIFLESSOLOGIA, CHE DIMOSTRANO CHE GRAZIE AL DISPOSITIVO SI OTTIENE UN RAPIDO E OTTIMALE RIEQUILIBRIO BIOENERGETICO.


N.B.: La GDV Camera è riconosciuta come strumento medico in molti degli Stati Federati degli Stati Uniti d'America, in Russia, in Bielorussia e in Inghilterra.

## PRIMO TEST

Nome soggetto testato: ARIANNA Dispositivo Utilizzato : NESSUNO in questa prova

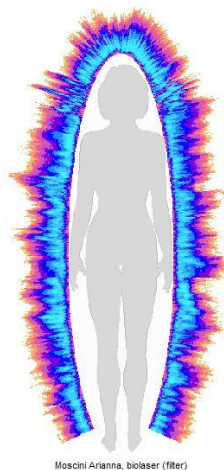

Il soggetto ha un livello energetico fisico **sotto la media** : Energia Fisica: **21797**

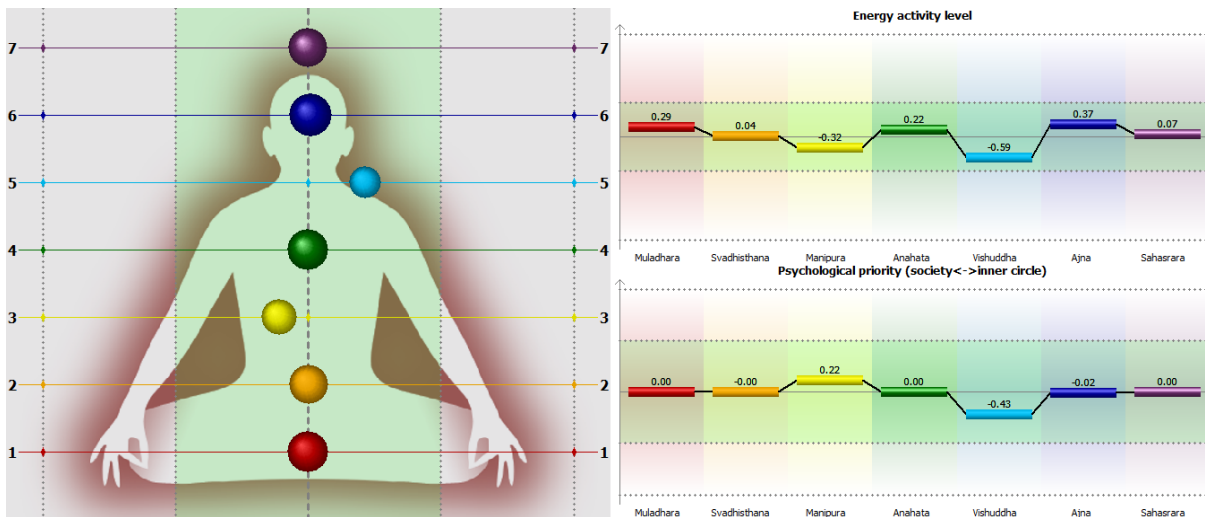


Il terzo e quinto chakra **non sono allineati**

GDV Diagram

Moscini Arianna - biolaser - GDV-images without filter


Integral area

Integral area  
Value: 0.02 (normal)




Integral area

Integral area  
Value: 0.02 (normal)




Integral entropy

Integral entropy  
Value: 1.62 (normal)




Integral entropy

Integral entropy  
Value: 1.67 (normal)



Activation coefficient

Activation coefficient  
Value: 1.79 (low)

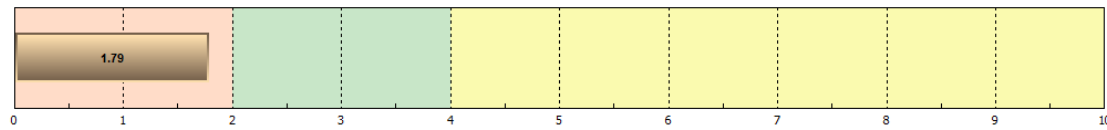

© Kirilronics Technologies International

Il soggetto ha un livello di stress **molto basso** rispetto a quello richiesto per essere in equilibrio.

## GDV Diagram


### Moscini Arianna - Capture 1 GDV-images with filter

	Finger & sector	Left side	Right side	Mean	Difference
<b>Right eye</b>	1R 1 + 1L 1	0.77	0.30	0.53	0.47
<b>Right ear, Nose, Maxillary sinus</b>	1R 2 + 1L 2	0.47	0.25	0.36	0.23
<b>Jaw, Teeth right side</b>	1R 3 + 1L 3	0.10	0.54	0.32	-0.44
<b>Throat, Larynx, Trachea, Thyroid gland</b>	1R 4 + 1L 4	0.76	0.37	0.57	0.39
<b>Jaw, Teeth left side</b>	1R 5 + 1L 5	0.67	-0.18	0.24	0.84
<b>Left ear, Nose, Maxillary sinus</b>	1R 6 + 1L 6	0.37	0.01	0.19	0.36
<b>Left eye</b>	1R 7 + 1L 7	0.18	0.66	0.42	-0.48
<b>Cerebral zone (cortex)</b>	1R 8 + 1L 8	0.31	0.64	0.47	-0.33
<b>Cervical zone</b>	2R 1 + 2L 8	0.28	0.37	0.33	-0.09
<b>Thorax zone</b>	2R 2 + 2L 7	-0.55	-0.40	-0.48	-0.14
<b>Lumbar zone</b>	2R 3 + 2L 6	-0.25	0.15	-0.05	-0.41
<b>Sacrum</b>	2R 4 + 2L 5	0.27	0.34	0.31	-0.07
<b>Coccyx, Pelvis minor zone</b>	2R 5 + 2L 4	0.70	0.54	0.62	0.15
<b>Blind gut</b>	2R 6		0.33		
<b>Appendix</b>	2R 7		0.09		
<b>Ascending colon</b>	2R 8		0.13		
<b>Transverse colon</b>	2R 9 + 2L 9	0.25	0.31	0.28	-0.07
<b>Descending colon</b>	2L 1	0.17			
<b>Sigmoid colon</b>	2L 2	0.20			
<b>Rectum</b>	2L 3	0.56			
<b>Thorax zone, Respiratory system</b>	3R 1 + 3L 6	0.29	0.34	0.32	-0.05
<b>Immune system</b>	3R 2 + 3L 5	0.05	-0.05	-0.00	0.10
<b>Gallbladder</b>	3R 3		0.07		
<b>Liver</b>	3R 4 + 3L 3	0.40	0.26	0.33	0.14
<b>Right kidney</b>	3R 5		0.15		
<b>Cardiovascular system</b>	3R 6 + 3L 1	0.09	0.14	0.11	-0.05
<b>Cerebral zone (vessels)</b>	3R 7 + 3L 7	0.20	0.24	0.22	-0.05
<b>Left kidney</b>	3L 2	0.46			
<b>Abdominal zone</b>	3L 4	0.11			
<b>Hypophysis</b>	4R 1 + 4L 8	0.48	0.25	0.37	0.23
<b>Thyroid gland</b>	4R 2 + 4L 7	0.41	0.09	0.25	0.32
<b>Pancreas</b>	4R 3 + 4L 6	0.23	0.22	0.22	0.01
<b>Adrenal</b>	4R 4 + 4L 5	0.24	0.60	0.42	-0.36
<b>Urino-genital system</b>	4R 5 + 4L 4	0.10	0.28	0.19	-0.18
<b>Spleen</b>	4R 6 + 4L 3	-0.30	0.03	-0.14	-0.33
<b>Nervous system</b>	4R 7 + 4L 2	-0.10	0.05	-0.03	-0.14
<b>Hypothalamus</b>	4R 8 + 4L 1	0.39	0.37	0.38	0.02
<b>Epiphysis</b>	4R 9 + 4L 9	0.27	0.27	0.27	0.00
<b>Duodenum</b>	5R 1		0.17		
<b>Ileum</b>	5R 2		0.02		
<b>Mammary glands, Respiratory system</b>	5R 3 + 5L 3	0.48	0.23	0.35	0.26
<b>Right kidney</b>	5R 4		0.16		
<b>Heart</b>	5R 5		0.13		
<b>Coronary vessels</b>	5R 6 + 5L 6	0.28	0.21	0.24	0.07
<b>Left part of heart</b>	5L 1	0.23			
<b>Left kidney</b>	5L 2	-0.21			
<b>Jejunum</b>	5L 4	0.31			
<b>Right part of heart</b>	5L 5	0.26			
<b>Activation coefficient</b>		1.45			
<b>Integral area</b>		0.23	0.20	0.21	0.04
<b>RMS of Integral area</b>		0.30	0.18	0.24	0.12
<b>Integral entropy</b>		2.04	1.85	1.94	0.19

Alcuni organi sono in ipofunzione

Dispositivo e tipo di intervento utilizzati su Arianna dopo la prima prova visibile sopra :  
BIOLASER® CON TRATTAMENTO DI PRONTO SOCCORSO IN DIEN CHAM, SECONDO IL METODO  
DEL M° NHUAN LE QUANG.


### RISULTATI OTTENUTI

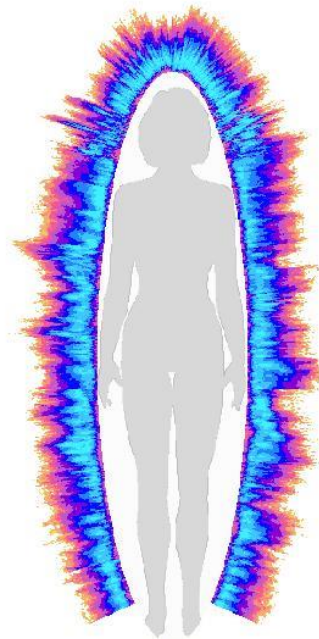

Moscini Arianna, biolaser (filter)

Energia Fisica: **22280** più alta rispetto a **21797** del test senza dispositivo


### CHAKRA

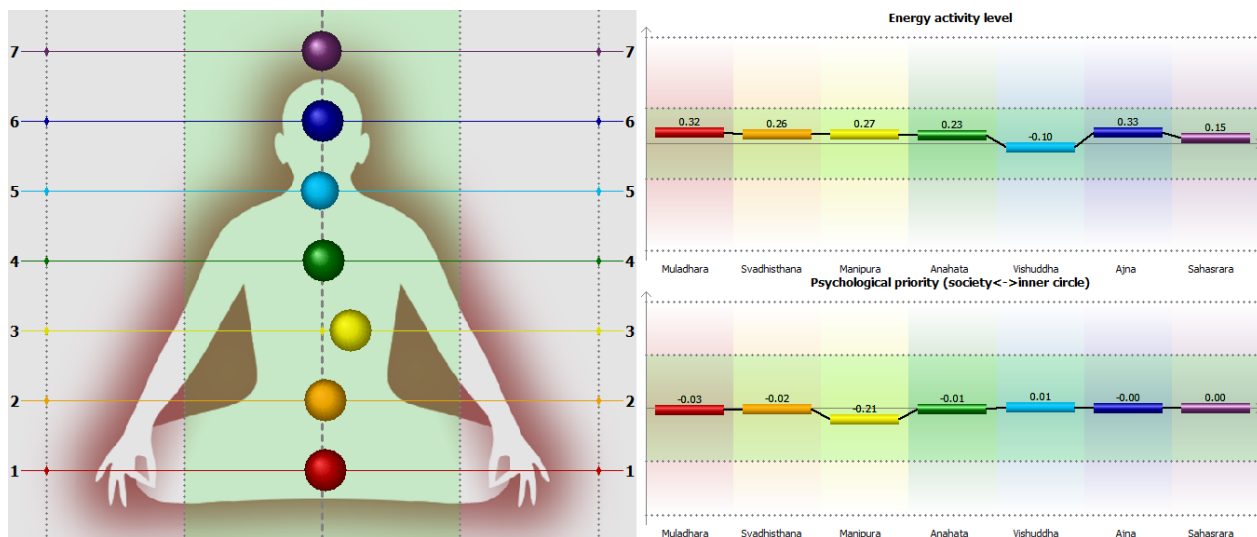

I chakra sono più allineati rispetto al primo test

GDV Diagram

Moscini Arianna - biolaser prot. Nhuan completo - GDV-images without filter

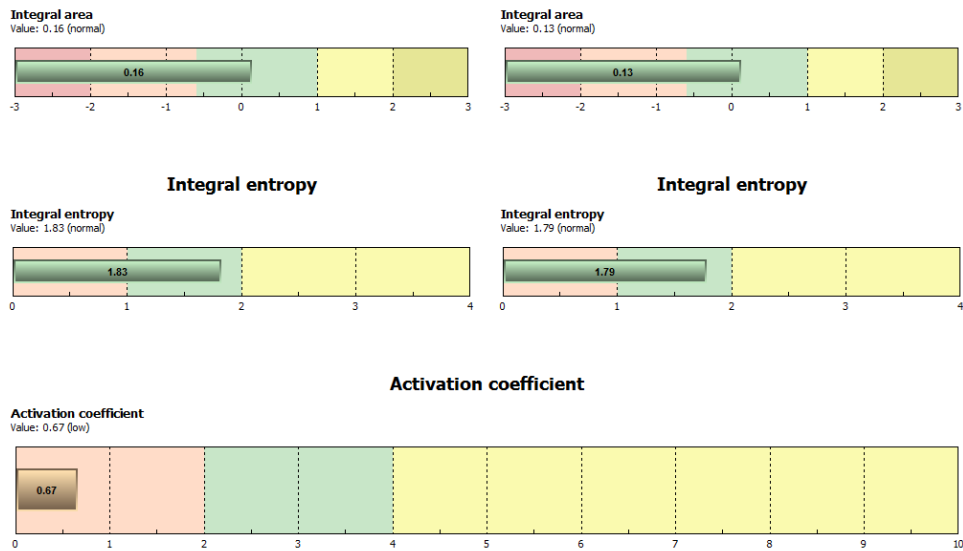

© Kirilions Technologies International

Il soggetto ha un livello di stress **migliore** rispetto al test sopra senza dispositivo

## GDV Diagram

### Moscini Arianna - biolaser prot. Nhuan completo GDV-images without filter

	Finger & sector	Left side	Right side	Mean	Difference
Right eye	1R 1 + 1L 1	0.33	0.02	0.17	0.31
Right ear, Nose, Maxillary sinus	1R 2 + 1L 2	0.22	0.22	0.22	0.00
Jaw, Teeth right side	1R 3 + 1L 3	-0.54	0.50	-0.02	-1.03
Throat, Larynx, Trachea, Thyroid gland	1R 4 + 1L 4	0.26	0.23	0.24	0.03
Jaw, Teeth left side	1R 5 + 1L 5	1.08	-0.35	0.37	1.43
Left ear, Nose, Maxillary sinus	1R 6 + 1L 6	0.63	0.26	0.45	0.37
Left eye	1R 7 + 1L 7	0.24	0.61	0.42	-0.36
Cerebral zone (cortex)	1R 8 + 1L 8	0.34	0.26	0.30	0.08
Cervical zone	2R 1 + 2L 8	0.22	0.09	0.16	0.13
Thorax zone	2R 2 + 2L 7	-0.07	0.08	0.00	-0.15
Lumbar zone	2R 3 + 2L 6	0.35	0.13	0.24	0.22
Sacrum	2R 4 + 2L 5	0.24	0.48	0.36	-0.24
Coccyx, Pelvis minor zone	2R 5 + 2L 4	0.82	0.77	0.80	0.05
Blind gut	2R 6		0.62		
Appendix	2R 7		0.19		
Ascending colon	2R 8		0.15		
Transverse colon	2R 9 + 2L 9	0.16	0.10	0.13	0.07
Descending colon	2L 1	0.14			
Sigmoid colon	2L 2	0.15			
Rectum	2L 3	0.81			
Thorax zone, Respiratory system	3R 1 + 3L 6	0.28	0.02	0.15	0.26
Immune system	3R 2 + 3L 5	0.16	-0.59	-0.22	0.75
Gallbladder	3R 3		-0.20		
Liver	3R 4 + 3L 3	0.54	0.29	0.41	0.25
Right kidney	3R 5		0.65		
Cardiovascular system	3R 6 + 3L 1	-0.10	0.28	0.09	-0.38
Cerebral zone (vessels)	3R 7 + 3L 7	0.05	0.08	0.07	-0.03
Left kidney	3L 2	0.16			
Abdominal zone	3L 4	0.27			
Hypophysis	4R 1 + 4L 8	0.34	0.15	0.24	0.19
Thyroid gland	4R 2 + 4L 7	0.22	0.20	0.21	0.02
Pancreas	4R 3 + 4L 6	0.23	0.27	0.25	-0.04
Adrenal	4R 4 + 4L 5	0.31	0.44	0.38	-0.13
Urino-genital system	4R 5 + 4L 4	0.02	-0.29	-0.14	0.31
Spleen	4R 6 + 4L 3	-0.75	-1.00	-0.88	0.25
Nervous system	4R 7 + 4L 2	-0.58	-0.17	-0.38	-0.41
Hypothalamus	4R 8 + 4L 1	-0.35	0.46	0.06	-0.81
Epiphysis	4R 9 + 4L 9	0.06	0.22	0.14	-0.16
Duodenum	5R 1		-0.14		
Ileum	5R 2		0.01		
Mammary glands, Respiratory system	5R 3 + 5L 3	0.38	0.62	0.50	-0.24
Right kidney	5R 4		0.14		
Heart	5R 5		0.11		
Coronary vessels	5R 6 + 5L 6	0.29	0.02	0.15	0.27
Left part of heart	5L 1	0.09			
Left kidney	5L 2	0.05			
Jejunum	5L 4	0.21			
Right part of heart	5L 5	0.13			
Activation coefficient		0.67			
Integral area		0.16	0.13	0.15	0.02
RMS of Integral area		0.37	0.37	0.37	0.00
Integral entropy		1.83	1.79	1.81	0.04

© Kirilronics Technologies International

La situazione degli organi si è modificata andando a far lavorare in particolare la milza , i denti e la mandibola

Considerazione n. 1 : lo stato fisico del soggetto è **migliorato** dopo il trattamento di pronto soccorso in Dien Cham, secondo il metodo del M° Nhuan Le Quang, praticato con il solo BIOLASER®

Il soggetto evidenzia uno stato fisico **MIGLIORE**

Osservazioni Finali: **IL TEST HA AVUTO ESITO POSITIVO.**


IL DISPOSITIVO ha apportato **miglioramenti Fisici** nel Soggetto Esaminato .

## SECONDO TEST

Nome soggetto testato: Arianna

Risultati ottenuti utilizzando il BIOLASER® con protocollo Dien Cham, del M° Nhuan Le Quang, completo.

Energia Fisica: **22356 ancor più alta** rispetto ai rilevamenti ottenuti con il trattamento di pronto soccorso in Dien Cham (**22280**), secondo il metodo del M° Nhuan Le Quang del **PRIMO TEST**, ma soprattutto rispetto a quella della prima prova senza dispositivo visibile all'inizio di questo documento (**21797**)

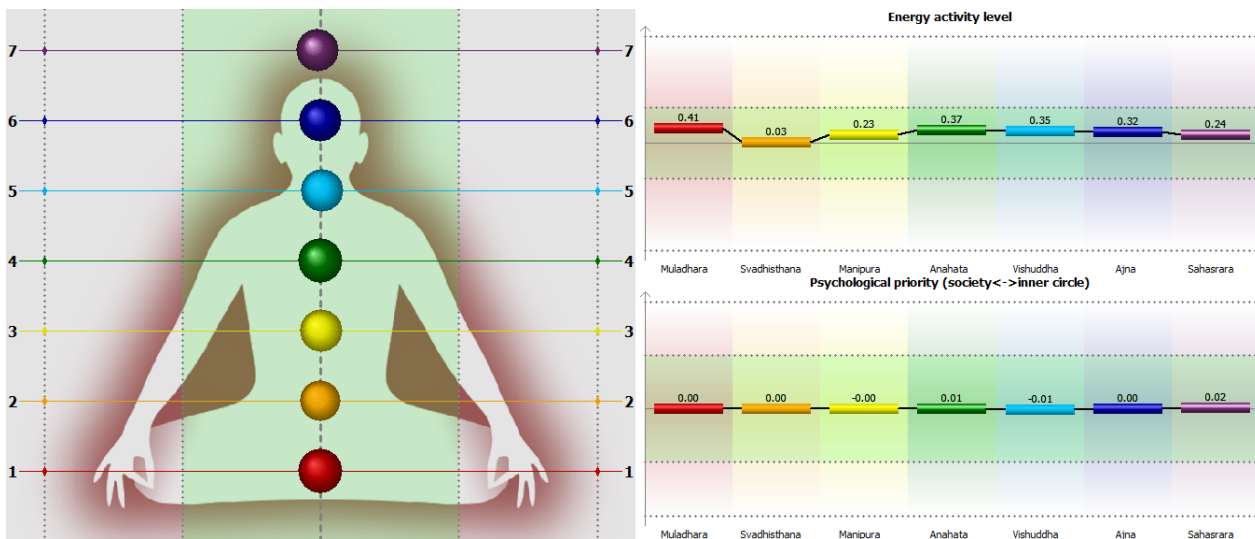


I chakra **SONO allineati completamente**


GDV Diagram

Moscini Arianna - biolaser prot. Nhuan completo - GDV-images without filter  
Integral area

Integral area  
Value: 0.16 (normal)




Integral area  
Value: 0.13 (normal)




Integral entropy

Integral entropy  
Value: 1.83 (normal)




Integral entropy

Integral entropy  
Value: 1.79 (normal)



Activation coefficient

Activation coefficient  
Value: 0.67 (low)



© Kirilronics Technologies International

Il soggetto ha un livello di stress ancor migliore rispetto ai valori del **PRIMO TEST**(vedi più sopra).



## GDV Diagram

### Moscini Arianna - biolaser prot. Nhuan completo GDV-images with filter

	Finger & sector	Left side	Right side	Mean	Difference
Right eye	1R 1 + 1L 1	0.59	-0.01	0.29	0.60
Right ear, Nose, Maxillary sinus	1R 2 + 1L 2	0.35	0.11	0.23	0.23
Jaw, Teeth right side	1R 3 + 1L 3	-0.60	0.57	-0.01	-1.17
Throat, Larynx, Trachea, Thyroid gland	1R 4 + 1L 4	0.29	0.53	0.41	-0.24
Jaw, Teeth left side	1R 5 + 1L 5	0.82	-0.35	0.24	1.17
Left ear, Nose, Maxillary sinus	1R 6 + 1L 6	0.60	0.23	0.42	0.37
Left eye	1R 7 + 1L 7	0.57	0.58	0.57	-0.00
Cerebral zone (cortex)	1R 8 + 1L 8	0.47	0.43	0.45	0.05
Cervical zone	2R 1 + 2L 8	0.25	0.14	0.20	0.12
Thorax zone	2R 2 + 2L 7	0.09	0.05	0.07	0.03
Lumbar zone	2R 3 + 2L 6	0.14	0.25	0.19	-0.10
Sacrum	2R 4 + 2L 5	0.33	0.44	0.38	-0.12
Coccyx, Pelvis minor zone	2R 5 + 2L 4	0.54	0.39	0.47	0.15
Blind gut	2R 6		0.28		
Appendix	2R 7		0.00		
Ascending colon	2R 8		0.05		
Transverse colon	2R 9 + 2L 9	0.27	0.34	0.30	-0.07
Descending colon	2L 1	0.12			
Sigmoid colon	2L 2	0.35			
Rectum	2L 3	0.74			
Thorax zone, Respiratory system	3R 1 + 3L 6	0.36	0.23	0.29	0.14
Immune system	3R 2 + 3L 5	0.38	0.36	0.37	0.01
Gallbladder	3R 3		0.33		
Liver	3R 4 + 3L 3	0.42	0.45	0.44	-0.03
Right kidney	3R 5		0.07		
Cardiovascular system	3R 6 + 3L 1	0.03	0.16	0.09	-0.13
Cerebral zone (vessels)	3R 7 + 3L 7	0.12	0.31	0.22	-0.19
Left kidney	3L 2	0.03			
Abdominal zone	3L 4	0.37			
Hypophysis	4R 1 + 4L 8	0.40	0.32	0.36	0.08
Thyroid gland	4R 2 + 4L 7	0.38	0.40	0.39	-0.02
Pancreas	4R 3 + 4L 6	0.40	0.40	0.40	0.00
Adrenal	4R 4 + 4L 5	0.27	0.31	0.29	-0.04
Urino-genital system	4R 5 + 4L 4	0.02	-0.04	-0.01	0.06
Spleen	4R 6 + 4L 3	-0.82	-1.06	-0.94	0.24
Nervous system	4R 7 + 4L 2	0.11	-0.46	-0.18	0.57
Hypothalamus	4R 8 + 4L 1	0.33	0.41	0.37	-0.08
Epiphysis	4R 9 + 4L 9	0.23	0.32	0.28	-0.09
Duodenum	5R 1		0.01		
Ileum	5R 2		0.15		
Mammary glands, Respiratory system	5R 3 + 5L 3	0.34	0.20	0.27	0.14
Right kidney	5R 4		0.01		
Heart	5R 5		0.36		
Coronary vessels	5R 6 + 5L 6	0.23	0.19	0.21	0.04
Left part of heart	5L 1	0.22			
Left kidney	5L 2	0.11			
Jejunum	5L 4	0.33			
Right part of heart	5L 5	0.10			
Activation coefficient		0.67			
Integral area		0.23	0.17	0.20	0.06
RMS of Integral area		0.29	0.34	0.32	-0.04
Integral entropy		1.40	1.60	1.50	-0.20

La situazione degli organi sta tornando alla normalità , con un equilibrio fisico migliore

Considerazione n. 1 : stato fisico del soggetto **migliorato notevolmente**

Il soggetto evidenzia uno stato **FISICO E UN LIVELLO DI STRESS MIGLIORI**

Osservazioni Finali: **IL TEST HA AVUTO ESITO POSITIVO .**


IL DISPOSITIVO ha apportato ancor maggiori miglioramenti Fisici del Soggetto Esaminato rispetto al trattamento effettuato con il solo BIOLASER® con l'intervento di Pronto Soccorso in Dien Cham del **PRIMO TEST.**

## TERZO TEST

Nome soggetto testato: Daniela

Dispositivo Utilizzato : **NESSUNO**


Note al primo Test GDV Camera SENZA Dispositivo

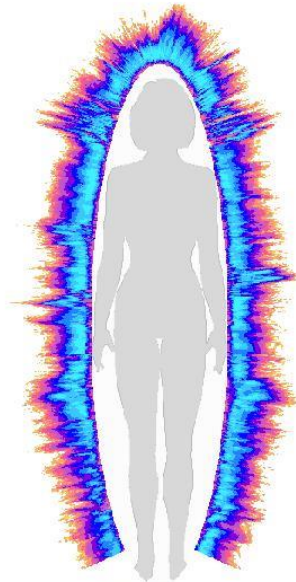

Daniela , prima (filter)

Energia Fisica: **20428**

Il soggetto ha un livello energetico fisico **sotto la media**

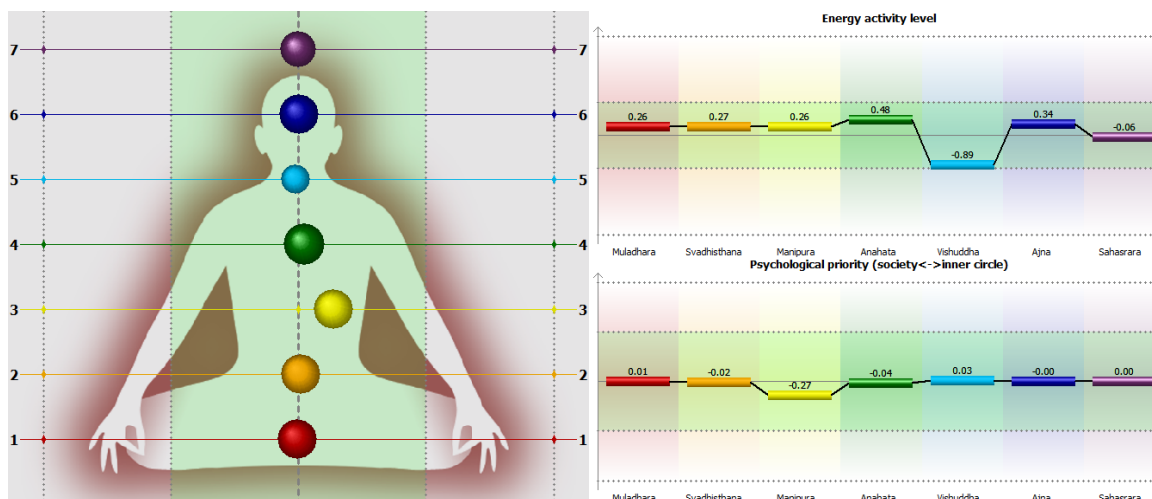


I chakra **non sono allineati**

Diagramma

**GDV Diagram**

**Daniela - prima - GDV-images without filter**

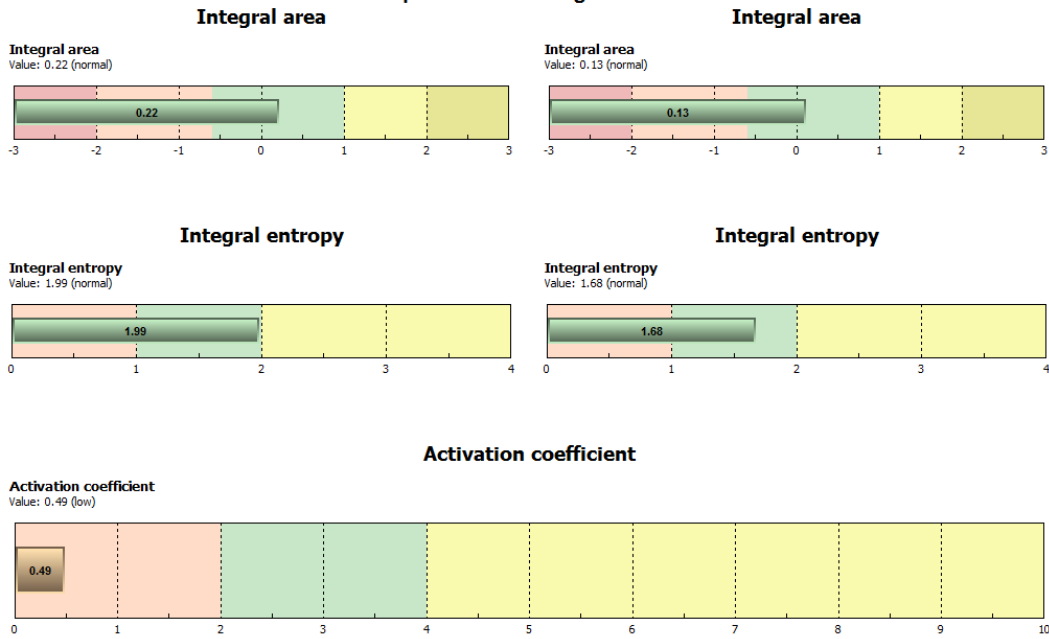

© Kirilronics Technologies International

Il soggetto ha un livello di stress **troppo basso** rispetto a quello richiesto per essere in equilibrio.


## GDV Diagram

### Daniela - prima GDV-images with filter

	Finger & sector	Left side	Right side	Mean	Difference
Right eye	1R 1 + 1L 1	0.28	0.25	0.26	0.02
Right ear, Nose, Maxillary sinus	1R 2 + 1L 2	0.07	0.47	0.27	-0.40
Jaw, Teeth right side	1R 3 + 1L 3	-0.76	0.83	0.04	-1.59
Throat, Larynx, Trachea, Thyroid gland	1R 4 + 1L 4	0.56	0.90	0.73	-0.35
Jaw, Teeth left side	1R 5 + 1L 5	0.80	0.01	0.40	0.79
Left ear, Nose, Maxillary sinus	1R 6 + 1L 6	0.60	0.16	0.38	0.45
Left eye	1R 7 + 1L 7	0.46	0.49	0.47	-0.03
Cerebral zone (cortex)	1R 8 + 1L 8	0.43	0.31	0.37	0.11
Cervical zone	2R 1 + 2L 8	0.24	0.10	0.17	0.14
Thorax zone	2R 2 + 2L 7	-0.23	-0.22	-0.23	-0.01
Lumbar zone	2R 3 + 2L 6	-0.41	0.08	-0.17	-0.49
Sacrum	2R 4 + 2L 5	0.12	0.48	0.30	-0.36
Coccyx, Pelvis minor zone	2R 5 + 2L 4	0.39	0.70	0.54	-0.30
Blind gut	2R 6		0.22		
Appendix	2R 7		0.04		
Ascending colon	2R 8		0.12		
Transverse colon	2R 9 + 2L 9	0.26	0.32	0.29	-0.06
Descending colon	2L 1	-0.21			
Sigmoid colon	2L 2	-0.21			
Rectum	2L 3	0.24			
Thorax zone, Respiratory system	3R 1 + 3L 6	0.44	0.22	0.33	0.22
Immune system	3R 2 + 3L 5	-0.24	-0.36	-0.30	0.12
Gallbladder	3R 3		0.07		
Liver	3R 4 + 3L 3	0.33	0.34	0.34	-0.02
Right kidney	3R 5		0.16		
Cardiovascular system	3R 6 + 3L 1	0.17	0.20	0.18	-0.03
Cerebral zone (vessels)	3R 7 + 3L 7	0.18	0.26	0.22	-0.08
Left kidney	3L 2	0.67			
Abdominal zone	3L 4	-0.39			
Hypophysis	4R 1 + 4L 8	0.31	0.15	0.23	0.15
Thyroid gland	4R 2 + 4L 7	-0.23	-0.02	-0.12	-0.21
Pancreas	4R 3 + 4L 6	0.12	0.21	0.16	-0.09
Adrenal	4R 4 + 4L 5	0.26	0.30	0.28	-0.04
Urino-genital system	4R 5 + 4L 4	0.29	0.23	0.26	0.05
Spleen	4R 6 + 4L 3	0.12	-0.38	-0.13	0.51
Nervous system	4R 7 + 4L 2	0.02	0.10	0.06	-0.09
Hypothalamus	4R 8 + 4L 1	0.10	0.48	0.29	-0.38
Epiphysis	4R 9 + 4L 9	0.18	0.32	0.25	-0.14
Duodenum	5R 1		-0.67		
Ileum	5R 2		-0.50		
Mammary glands, Respiratory system	5R 3 + 5L 3	0.09	-0.07	0.01	0.17
Right kidney	5R 4		-0.01		
Heart	5R 5		-0.12		
Coronary vessels	5R 6 + 5L 6	0.22	-0.04	0.09	0.26
Left part of heart	5L 1	0.25			
Left kidney	5L 2	-0.38			
Jejunum	5L 4	0.12			
Right part of heart	5L 5	-0.22			
Activation coefficient		0.49			
Integral area		0.13	0.14	0.13	-0.02
RMS of Integral area		0.30	0.35	0.32	-0.05
Integral entropy		1.76	2.00	1.88	-0.24

Alcuni organi evidenziati in rosso sono in ipofunzione


Dispositivo e tipo di intervento utilizzati su Daniela, dopo la prima prova del terzo test senza dispositivo visibile sopra: BIOLASER® con protocollo Dien Cham del M° Nhuan Le Quang completo con l'aggiunta del trattamento finale di Linfodrenaggio, eseguito sempre con il solo BIOLASER®.

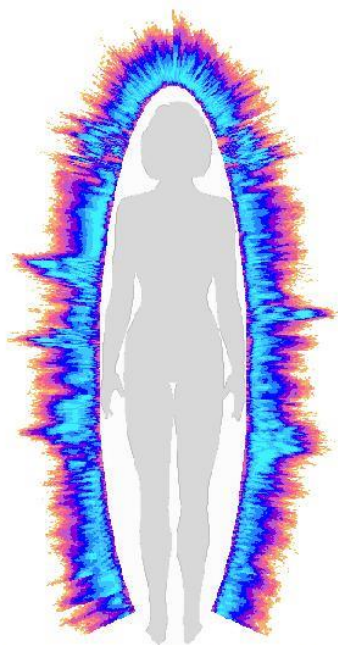

Daniela , Biolaser Protocollo Nuan cn linfodrenaggio (filter)

Energia Fisica: **22600 più alta** rispetto al test sopra senza dispositivo che era di **20428**


CHAKRA

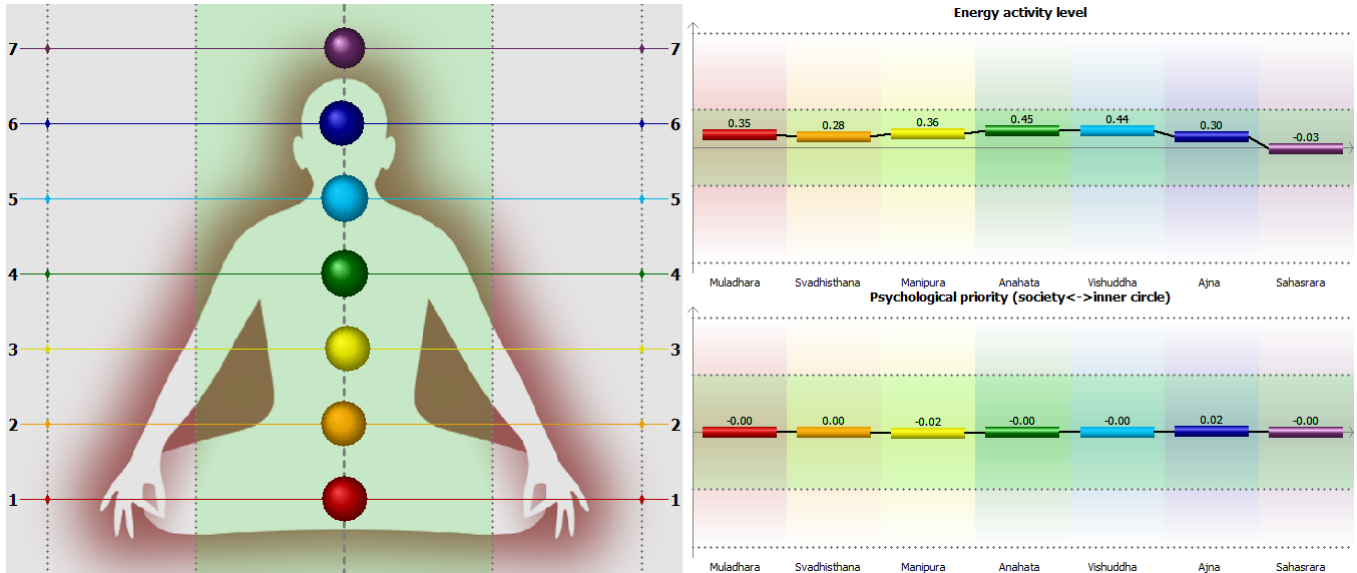

I chakra sono ora molto ben allineati

GDV Diagram

Daniela - Biolaser Protocollo Nuan cn linfodrenaggio - GDV-images without filter

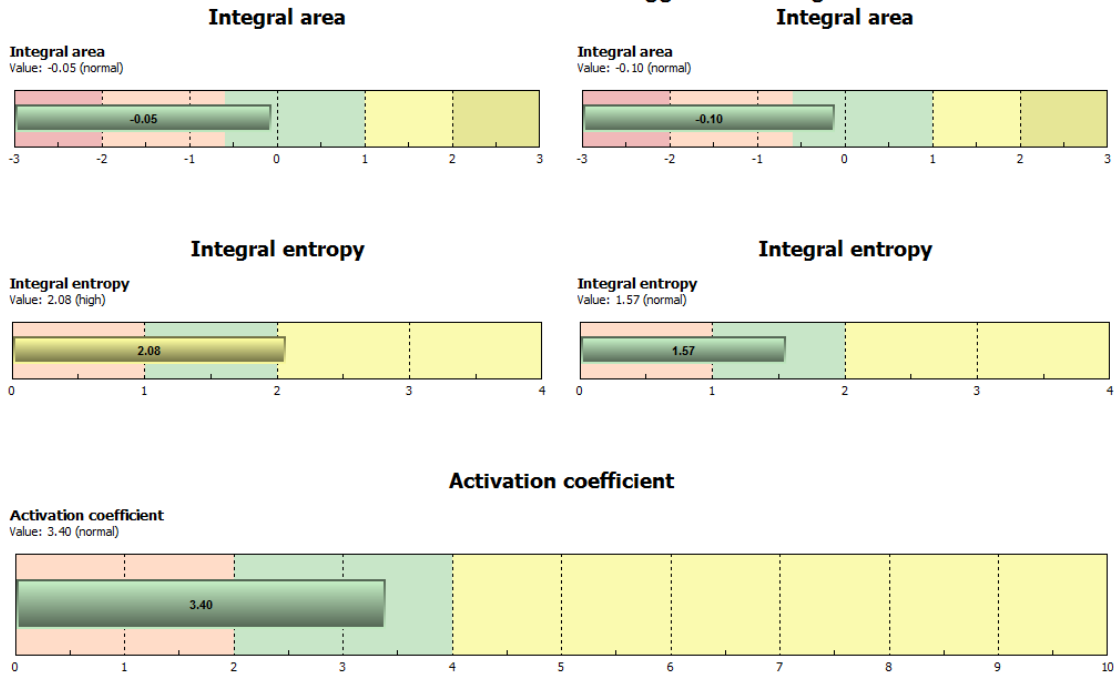

© Kirionics Technologies International

Il soggetto ha un livello di stress riequilibrato completamente

Considerazione n. 1 : stato fisico del soggetto **migliorato notevolmente**

Il soggetto evidenzia, grazie al trattamento completo con il solo BIOLASER® descritto sopra, **uno stato fisico e un livello di stress globali notevolmente migliori.**

Osservazioni Finali: **IL TEST HA AVUTO ESITO POSITIVO** .

I Test sono stati effettuati dalla Dott.ssa Monica Carlomagno e da Massimiliano Giacchetti.